


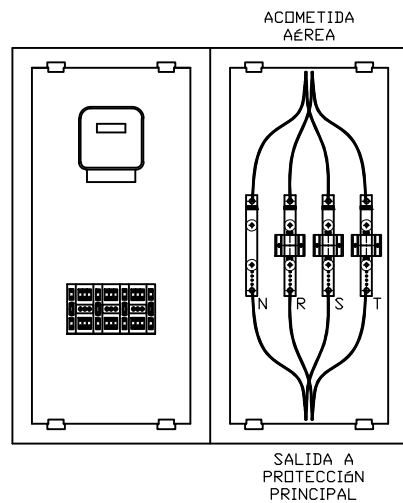


Tapa de fondo metálico desmontable para fijar equipo de medición.

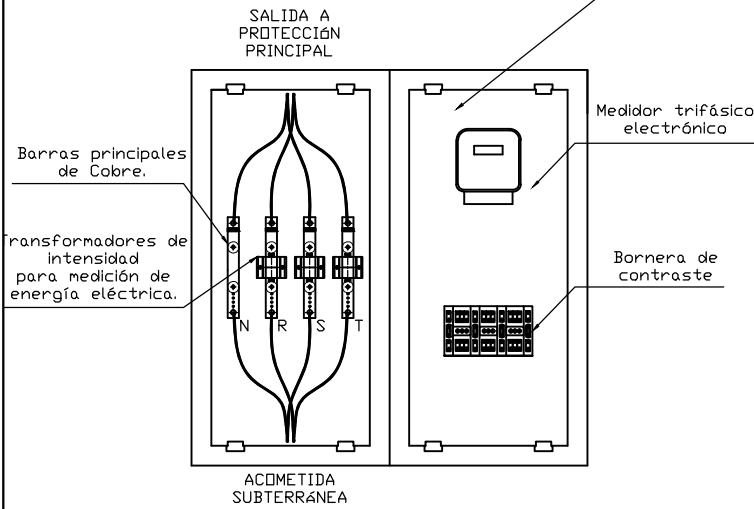

GABINETE CON INTERRUPTOR TETRAPOLAR COINCIDENTE CON EL COMPARTIMIENTO DE BARRAS



GABINETE CON INTERRUPTOR TETRAPOLAR COINCIDENTE CON EL COMPARTIMIENTO DE BARRAS

DETALLE: ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

DETALLE: ACOMETIDA AÉREA



Cooperativa de Servicios Públicos Sociales y Viviendas de Avellaneda Ltda.

	Fecha	Nombre	Cliente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Dibujó					
Revisó					
Aprobó	—	—	Obra: xxxx ACOMETIDAS		
Escala:	<p>ACOMETIDAS EN BT.</p> <p>DETALLE DE GABINETE DE MEDICIÓN.</p>		N° de Plano Cliente:	Rev.	
ESC			XXXXXX		
			N° de Obra:	---	
Tolerancia			N° de Plano:	XXXXXX	Rev.
Rugocidad				0	